Coupes pour la mesure de la viscosité des liquides

COUPE Nº 4 SELON NORME DIN 53211.
COUPES SELON NORME ISO 2431.
COUPES FORD SELON NORME ASTM D-1200.
CAPACITÉ: 100 ML.

CARACTÉRISTIQUES

Pour viscosités cinématiques de 5 à 700 cSt, selon modèle.
Coupe métallique estampée en laiton, étalonnée et chromée.



Coupes à anse.
Modèles DIN 53211 Nº 4
et Ford ASTM D-1200.




Coupes. Modèles standard.

ACCESSOIRE
Support et disque d arasement à niveau.
Code 7001021

MODÈLES

Code	Norme	Calibre Ø mm	Format	Plage cSt	Temps écoulement admissibles
1000123	DIN 53211	4	Standard	90 a 700	25 a 100
1000347	DIN 53211	4	Avec anse	90 a 700	25 a 100
1001013	ISO 2431	3	Standard	5 a 42	30 a 100
1001014	ISO 2431	4	Standard	35 a 135	30 a 100
1001015	ISO 2431	5	Standard	100 a 350	30 a 100
1001016	ISO 2431	6	Standard	190 a 680	30 a 100
1000705	ASTM D-1200	3,40	Standard	40 a 220	20 a 100
		4,12		70 a 370	20 a 100
		2,53		25 a 120	20 a 100
1000707	ASTM D-1200	3,40	Avec anse	40 a 220	20 a 100
		4,12		70 a 370	20 a 100

Livré avec certificat du résultat de calibration avec appareils de mesure et patrons utilisés.

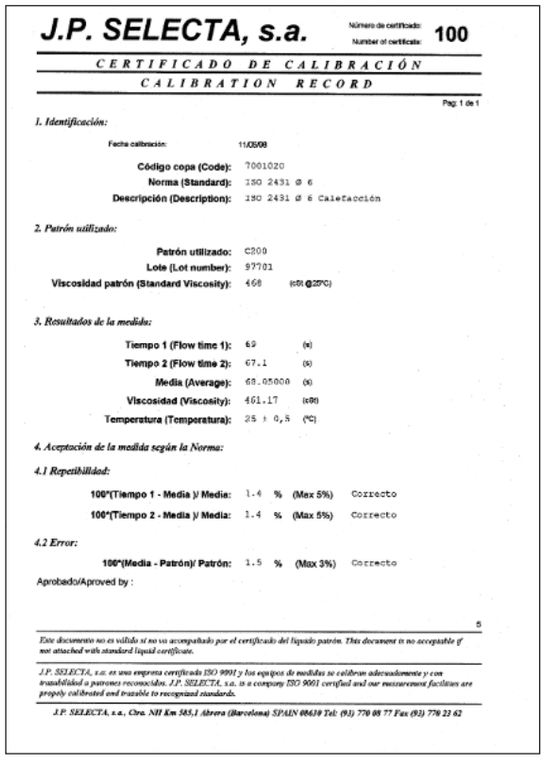

J.P. SELECTA, s.a. Número de certificado: Number of certificate: 100

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RECORD

Pag: 1 de 1

1. Identificación:

Fecha calibración: 11/05/98
Código copa (Code): 7001020
Norma (Standard): ISO 2431 Ø 6
Descripción (Description): ISO 2431 Ø 6 Calefacción

2. Patrón utilizado:

Patrón utilizado: C200
Lote (Lot number): 97701
Viscosidad patrón (Standard Viscosity): 468 (cSt @25ºC)

3. Resultados de la medida:

Tiempo 1 (Flow time 1): 69 (s)
Tiempo 2 (Flow time 2): 67.1 (s)
Media (Average): 68.05000 (s)
Viscosidad (Viscosity): 461.17 (cSt)
Temperatura (Temperatura): 25 ± 0,5 (ºC)

4. Aceptación de la medida según la Norma:

4.1 Repetibilidad:

100*(Tiempo 1 - Media)/ Media: 1.4 % (Max 5%) Correcto
100*(Tiempo 2 - Media)/ Media: 1.4 % (Max 5%) Correcto

4.2 Error:

100*(Media - Patrón)/ Patrón: 1.5 % (Max 3%) Correcto

Aprobado/Aproved by :

5

Este documento no es válido si no va acompañado por el certificado del líquido patrón. This document is no acceptable if not attached with standard liquid certificate.

J.P. SELECTA, s.a. es una empresa certificada ISO 9001 y los equipos de medidas se calibran adecuadamente y con trazabilidad a patrones reconocidos. J.P. SELECTA, s.a. is a company ISO 9001 certified and our measurement facilities are properly calibrated and traceable to recognized standards.

J.P. SELECTA, s.a., Ctra. NH Km 585,1 Abrera (Barcelona) SPAIN 08630 Tel: (93) 770 08 77 Fax (93) 770 23 62